

# SwissRDL-Registrierungssystem:

## Neue Implantat-Schnittstelle

### 1 Einführung

Wir haben die Implantat-Schnittstelle aktualisiert, um die Qualität der eingegebenen Implantate zu verbessern. Dieses Handbuch beschreibt die Elemente der verbesserten Schnittstelle, erklärt die neuen Suchfunktionen und zeigt, wie man eine Favoritenliste aufbaut.

### 2 Abschnitte der Schnittstelle

Das Bild unten zeigt die neue Implantatschnittstelle. Sie ist in drei Abschnitte unterteilt:

- **Ausgewählte Implantate**
- **Implantat-Suche**
- **Die Suchergebnisse**

**Ausgewählte Implantate**

Hersteller	Artikelnummer	Lot-Nummer	Beschreibung	
Smith & Nephew	75018959	B1820928	XLPE-Einsatz 55/28	

**Implantat-Suche**

☒ Manuell ☐ Scannen

Hersteller \*

Hersteller nicht in der Liste? ☐

Artikelnummer \*

Artikel nicht gefunden? ☐


**Suchergebnisse**

Hersteller	Artikelnummer ▲	Lot-Nummer	Beschreibung		
Smith & Nephew	75000176	<input type="text"/>	MIA Schaft mit Ti/HA 3		

Artikel nicht gefunden? Kreuzen Sie das Kästchen "Artikel nicht gefunden?", geben Sie die nötigen Informationen an und klicken Sie auf Speichern. Bitte senden Sie ein Bild des Produktaufklebers an [implants.ispm@unibe.ch](mailto:implants.ispm@unibe.ch). Wir werden das Produkt überprüfen und zur Implantatbibliothek hinzufügen.

## 2.1 Ausgewählte Implantate

Solange keine Implantate hinzugefügt wurden, ist dieser Abschnitt leer. Sobald Implantate hinzugefügt wurden, wird diese Liste für jedes Implantat angezeigt: Hersteller, Artikel-Nr., Lot-Nr. und Beschreibung. Wenn Sie ein Implantat löschen möchten, klicken Sie auf das **blaue Mülleimer-Symbol**.

Ausgewählte Implantate				
Hersteller	Artikelnummer	Lot-Nummer	Beschreibung	
Smith & Nephew	75018959	B1820928	XLPE-Einsatz 55/28	

## 2.2 Implantat-Suche

Sie können nach Implantaten suchen, entweder manuell (klicken Sie auf **Manuell**) oder durch Scannen von Barcodes (klicken Sie auf **Scannen**). Wenn Sie auf Ihre Lieblingsartikel zugreifen möchten, klicken Sie auf **Favoriten**.

**Implantat-Suche**

☒ **Manuell** ☐ **Scannen**


Hersteller \*


Bitte wählen... ▾


Hersteller nicht in der Liste?


☐

Artikelnummer \*

 Suchen



 Zurücksetzen

 **Favoriten**



## 2.3 Suchergebnisse

Die Ergebnisse Ihrer Suche werden in der Suchergebnisliste angezeigt. Um ein Implantat zu einem Fall hinzuzufügen, geben Sie die **Lot-Nummer** ein (falls nicht bereits beim Scannen eingegeben) und klicken Sie auf das **grüne Plus-Symbol**. Das Implantat wird dann im Abschnitt "Ausgewählte Implantate" angezeigt. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, Implantate zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, indem Sie auf das **gelbe Sternsymbol** klicken (weitere Details unten).

Suchergebnisse				
<u>Hersteller</u>	<u>Artikelnummer</u> ▲	<u>Lot-Nummer</u>	<u>Beschreibung</u>	
Smith & Nephew	75000176	<div>B1705985</div>	SL-PLUS Integr MIA Stem with Ti/HA 3	 

### 3 Manuelle Implantatsuche

**Erster Schritt:** Wählen Sie den **Hersteller** (nicht den Vertreiber!) des Implantats mit Hilfe der Dropdown-Liste aus. Die Liste enthält alle in unserer Implantatbibliothek registrierten Hersteller.

**Fall 1:** Der Hersteller **ist** in der Liste enthalten: Gehen Sie zu "**3.1 Ein Implantat für einen bestehenden Hersteller suchen und hinzufügen**".

**Fall 2:** Der Hersteller **ist nicht** in der Liste aufgeführt: Gehen Sie zu "**3.2 Ein Implantat für einen neuen Hersteller hinzufügen**".

Implantat-Suche

☒ Manuell ☐ Scannen

Hersteller \*

Hersteller nicht in der Liste? ☐

Artikelnummer \*

### 3.1 Ein Implantat für einen bestehenden Hersteller suchen und hinzufügen

Geben Sie die **Artikelnummer (auch REF-Nummer genannt)** des zu suchenden Implantats ein. Sie können nur die ersten paar Zeichen einer Artikelnummer eingeben und Return drücken oder auf **Suchen** klicken. Sonderzeichen (z.B. "/", "-", ".", usw.) können weggelassen werden.

**Implantat-Suche**  
☒ Manuell ☐ Scannen

Hersteller \*  
Hersteller nicht in der Liste?  
Artikelnummer \*  
Artikel nicht gefunden?

Smith & Nephew

☐

7133185

☐

Suchen

Zurücksetzen

Favoriten

?

**Suchergebnisse**

Hersteller	Artikelnummer ▲	Lot-Nummer	Beschreibung		
Smith & Nephew	71331850	<input type="text"/>	R3 0 HOLE ACET SHELL 50MM	+	★
Smith & Nephew	71331852	<input type="text"/>	R3 0 HOLE ACET SHELL 52MM	+	★
Smith & Nephew	71331854	<input type="text"/>	R3 0 HOLE ACET SHELL 54MM	+	★
Smith & Nephew	71331856	<input type="text"/>	R3 NO HOLE ACET SCHALE 56MM	+	★
Smith & Nephew	71331858	<input type="text"/>	R3 0 HOLE ACET SHELL 58MM	+	★

Das System zeigt Ihnen nicht mehr als 10 Suchergebnisse in der Liste an. Wenn es mehr Ergebnisse gibt, die mit der von Ihnen eingegebenen Artikelnummer übereinstimmen, werden Sie aufgefordert, Ihre Artikelnummer genauer einzugeben und erneut zu suchen.

**Implantat-Suche**  
☒ Manuell ☐ Scannen

Hersteller \*  
Hersteller nicht in der Liste?  
Artikelnummer \*  
Artikel nicht gefunden?

Smith & Nephew

☐

75

☐

Suchen

Zurücksetzen

Favoriten

?

**Suchergebnisse**


**Zu viele Einträge im Suchergebnis, bitte geben Sie die Artikelnummer genauer ein**

### 3.1.1 Ein Implantat zu einem Fall hinzufügen

Um ein Implantat zu einem Fall hinzuzufügen, geben Sie die **Lot-Nummer** ein und klicken Sie auf das **grüne Plus-Symbol**. Das Implantat erscheint dann im Abschnitt "Ausgewählte Implantate".

**Implantat-Suche**





☒ Manuell ☐ Scannen

Hersteller \*  



Hersteller nicht in der Liste? ☐

Artikelnummer \*

Artikel nicht gefunden? ☐

 Suchen  Zurücksetzen  Favoriten 

**Suchergebnisse**


Hersteller	Artikelnummer ▲	Lot-Nummer	Beschreibung		
Smith & Nephew	71331852	<input type="text" value="18DW20923"/>	R3 0 HOLE ACET SHELL 52MM		

### 3.1.2 Artikelnummer nicht erkannt

Wenn das von Ihnen gesuchte Implantat nicht gefunden werden konnte, überprüfen Sie bitte die eingegebene Artikel-Nr. sorgfältig und suchen Sie erneut. Wenn es immer noch nicht gefunden wurde, kreuzen Sie das Kästchen **Artikel nicht gefunden?** an, füllen Sie die restlichen Felder aus (d.h. **Artikelbeschreibung**, **Lot-Nummer**) und klicken Sie auf **Speichern**. Wenn möglich, senden Sie bitte ein Bild des Implantataufklebers an [implants.ispm@unibe.ch](mailto:implants.ispm@unibe.ch). Wir werden das Produkt prüfen und in die Implantatbibliothek aufnehmen.

**Implantat-Suche**

☒ Manuell ☐ Scannen

Hersteller \*  




Hersteller nicht in der Liste? ☐

Artikelnummer \*

Artikelbeschreibung \*

Lot-Nummer

Artikel nicht gefunden? ☒

 Speichern  Zurücksetzen 

**Suchergebnisse**

Keine Daten gefunden

Artikel nicht gefunden? Kreuzen Sie das Kästchen "Artikel nicht gefunden?", geben Sie die nötigen Informationen an und klicken Sie auf Speichern. Bitte senden Sie ein Bild des Produktaufklebers an [implants.ispm@unibe.ch](mailto:implants.ispm@unibe.ch). Wir werden das Produkt überprüfen und zur Implantatbibliothek hinzufügen.

### 3.2 Ein Implantat für einen neuen Hersteller hinzufügen

Wenn der Hersteller nicht in der Dropdown-Liste enthalten ist, kreuzen Sie das Kontrollkästchen **Hersteller nicht in der Liste an?**

Geben Sie Folgendes manuell ein:




- **Hersteller**
- **Artikelnummer (auch bekannt als REF-Nummer)**
- **Artikelbeschreibung**
- **Lot-Nummer**

Klicken Sie abschließend auf **Speichern**.

**Implantat-Suche**


☒ Manuell ☐ Scannen

Hersteller	*	OHST
Hersteller nicht in der Liste?		<input checked="" type="checkbox"/>
Artikelnummer	*	654321
Artikelbeschreibung	*	Beschreibung
Lot-Nummer		123456


 **Speichern**  **Zurücksetzen** 

### 3.3 Favoriten

Implantate, die Sie recht häufig verwenden, können Sie durch Klicken auf **das gelbe Sternchen-Symbol** zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

Suchergebnisse					
Hersteller	Artikelnummer ▲	Lot-Nummer	Beschreibung		
Smith & Nephew	71331852		R3 0 HOLE ACET SHELL 52MM		

Zu den **Favoriten** hinzugefügte Implantate können ohne Suche direkt zu den Fällen hinzugefügt werden: Sie klicken einfach auf Favoriten und Ihre Liste wird sofort angezeigt. Nach Eingabe der **Lot-Nummer** können Sie einen Artikel durch Klicken auf das **grüne Plus-Symbol** hinzufügen.


 Suchen  Zurücksetzen  **Favoriten** 

Suchergebnisse					
Hersteller	Artikelnummer ▲	Lot-Nummer	Beschreibung		
Smith & Nephew	71331852	18DW20923	R3 0 HOLE ACET SHELL 52MM		

## 4 Implantate scannen

Wenn Sie einen Barcode-Scanner an Ihrem Computer angeschlossen haben (z.B. Datalogic Gryphon), können Implantate einfach durch Scannen der zugehörigen Barcodes hinzugefügt werden. Bitte beachten Sie, dass dieser Abschnitt nichts mit dem SEDICO-Scannen zu tun hat.

Um Implantate zu scannen, gehen Sie zum Abschnitt Implantatsuche und kreuzen Sie das Kästchen **Scannen** an. Es werden zwei Barcode-Felder, **Strichcode 1** und **Strichcode 2**, angezeigt.

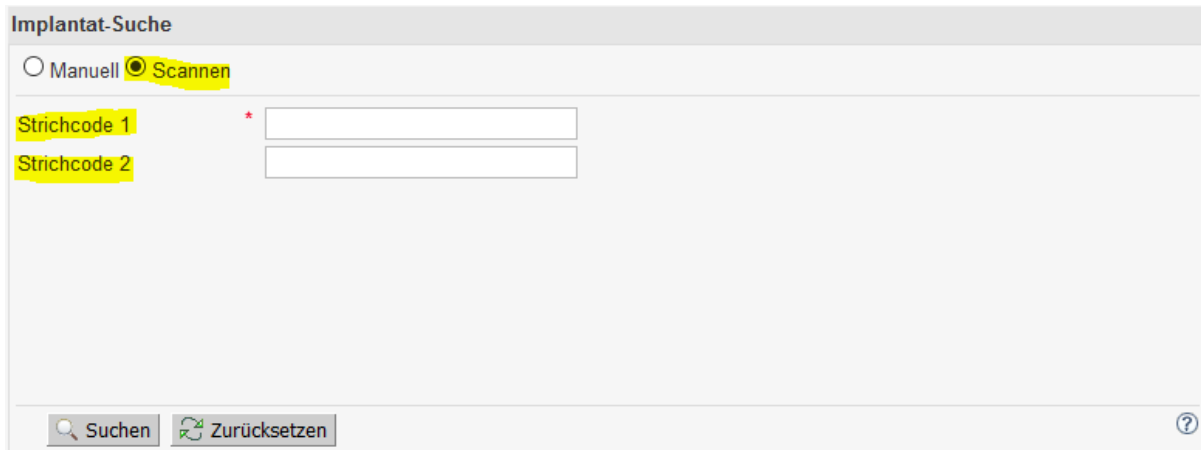

### Fall 1: nur ein Strichcode auf dem Aufkleber

Scannen Sie ihn bitte immer in das Feld Strichcode 1 ein (Pflichtfeld).

### Fall 2: mehr als ein Barcode auf dem Aufkleber

Bitte scannen Sie immer den Barcode mit entweder der Global Trade Item Number (GTIN) oder der Artikelnummer in das Feld Strichcode 1 ein (Pflichtfeld). Strichcodes, die GTINs enthalten, haben manchmal eine **führende Anwendungskennung "(01)"**.



Je nach den Einstellungen Ihrer Scannerkonfiguration müssen Sie möglicherweise auf **Suchen** klicken, um die Suche zu starten und Ihr Implantat abzurufen.

Implantat-Suche

☐ Manuell
 ☒ Scannen

Strichcode 1 \*

6300308076191723071510182626

Strichcode 2

Suchen

Zurücksetzen

?

#### 4.1 Das Implantat zu einem Fall hinzufügen

Um das Implantat zu einem Fall hinzuzufügen, geben Sie gegebenenfalls die **Lotnummer** ein und klicken Sie auf das **"grüne Plus"-Symbol**. Das Implantat erscheint im Abschnitt "Ausgewählte Implantate".

Implantat-Suche

☐ Manuell
 ☒ Scannen

Strichcode 1 \*

6300308076191723071510182626

Strichcode 2

Artikel nicht gefunden?

☐

Suchen

Zurücksetzen

?

Suchergebnisse

Hersteller	Artikelnummer	Lot-Nummer	Beschreibung			
Medacta	01.26.3248HCT	182626	Versafitcup® Liner PE HC Flat Ø32 / F			



## 1.1 Barcode ist nicht erkannt

Falls das Implantat nicht gefunden werden konnte, kreuzen Sie das Kästchen **Artikel nicht gefunden?** an, füllen Sie die restlichen Felder aus (d.h. **Hersteller**, **Artikelbeschreibung**, **Lotnummer**) und klicken Sie auf **Speichern**. Wenn möglich, senden Sie bitte ein Bild des Implantataufklebers an [implants.ispm@unibe.ch](mailto:implants.ispm@unibe.ch). Wir werden das Produkt prüfen und in die Implantatbibliothek aufnehmen.

**Implantat-Suche**

☐ Manuell ☒ Scannen

Strichcode 1 \*

123456

Strichcode 2

Hersteller \*

OHST

Hersteller nicht in der Liste?

☒

Artikelbeschreibung \*


Beschreibung


Lot-Nummer


654321

Artikel nicht gefunden?

☒

 Speichern

 Zurücksetzen



**Suchergebnisse**

Keine Daten gefunden

Artikel nicht gefunden? Kreuzen Sie das Kästchen "Artikel nicht gefunden?", geben Sie die nötigen Informationen an und klicken Sie auf Speichern. Bitte senden Sie ein Bild des Produktaufklebers an [implants.ispm@unibe.ch](mailto:implants.ispm@unibe.ch). Wir werden das Produkt überprüfen und zur Implantatbibliothek hinzufügen.